

更換電池的方式

電池種類與數量：鹼錳鈕釦型電池LR41（市售品）

更換電池圖示


若開啟電源後出現右圖般
圖示時，請更換電池。




更換方式

※當體溫計沾到水時，請勿開啟電池蓋。

- 以小型螺絲起子卸下體溫計背面的電池蓋螺絲，並將電池蓋拆下。

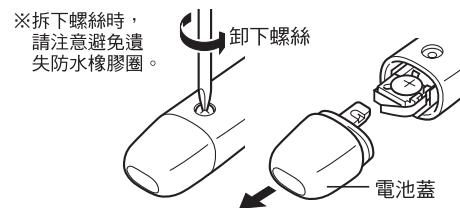

- 以不容易彎折的細長物體將電池拆下。



※拆除電池時，電池可能會飛出，敬請多加注意。

- 以圖中方式將電池（十字面朝上）裝入。



- 請將電池蓋依照原有方式裝回，並以螺絲加以固定。



使用須知

- 當您購買本產品時，產品中已裝有試用電池。這種試用電池的電力僅能使用本產品數次，敬請見諒。

- 關於已不堪使用的電池與本產品的廢棄方式，請遵照您居住地所在的行政區法規規定。

規格

產品名稱	"歐姆龍"電子體溫計 型號：MC-171W
電源電壓	DC 1.5V (鹼錳鈕釦型電池 LR41 X 1個)
消耗電力	0.1mW
電池使用壽命	約1100次（每天使用10分鐘，約可使用三年）
感溫部位	熱敏電阻
測量方式	實際測量
體溫顯示方式表示	3位數+°C圖示， 單位：每0.1°C
精密度	±0.1°C(於標準室溫23°C下， 於恒溫水槽實際測量的情況)
測量範圍	32.0~42.0°C
使用環境溫溼度	環境溫度：+10~+40°C， 相對濕度：30~85%RH
附屬品	●測試用電池 (鹼錳鈕釦型電池LR41 X 1個) ●收藏盒 ●使用說明書

符合EMC規範

本商品符合EMC規格 IEC 60601-1-2 : 2001



廢電池請回收

製造業者名稱及地址：Manufactured by OMRON DALIAN CO., LTD(地址: No.3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, China) for OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (地址: 53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002, Japan)。
醫療器材商名稱：臺灣歐姆龍健康事業股份有限公司
醫療器材商地址：台北市松山區復興北路367號9樓

使用說明書

"歐姆龍"電子體溫計

"OMRON" Electronic Thermometer


衛署醫器陸輸字第000171號

型號：MC-171W

腋下・口含

採用防水規格，可完全放入水中清洗，因此能常保清潔
(符合JIS基準的防滲透型式)

不容易移位的平板型感應器
大型平坦的感溫部位能完全貼合腋下或舌頭下方，避免於測量溫度的過程中產生移位。

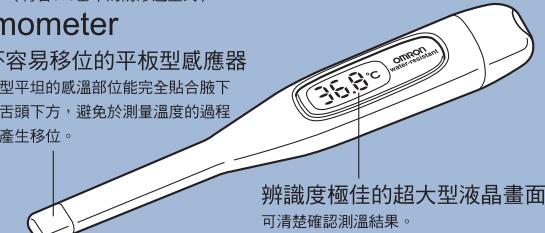


辨識度極佳的超大型液晶畫面
可清楚確認測溫結果。



體溫計的正確放入方式


於腋下測量時

- 頂住腋下的中央部位

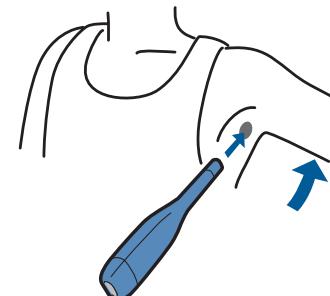

於口中測量時

- 頂住舌頭下方舌根的左方或右方



若有下列情況時將無法正確進行測量

- 運動，沐浴，進食後立即測量

請間隔30分鐘以上。



- 腋下出汗時

●長時間置身於棉被中時
請先擦乾腋下的汗水。



- 起床後剛開始活動時

請於起床後尚未活動前立即測量，若已開始活動，請間隔30分鐘以上後再行測量。

※這是因為起床後開始活動時，體溫或偏高所致。

實際的測量方式請閱覽本書內頁
1665294-0D

安全須知

使用前, 請務必詳閱以下內容。

以下標示的警告標誌及圖案是用來確保您正確及安全地操作本產品, 以避免使用者及旁人的生命或財產遭受損害。(標誌及其含意說明如下。)

■警告標誌的含意

⚠ 警告 表示操作錯誤時, 恐有造成人員傷亡之虞。

⚠ 注意 若操作錯誤, 可能造成人身傷害或物品損壞之內容。

※所有物品損壞是指房屋／家產以及家畜／寵物等相關廣義範圍的損壞。

■圖例

! ●記號代表強制 (務必遵守) | ○ ●記號代表禁止 (不允許) | △ ●記號代表注意 (包含警告與危險意識)

⚠ 警告

自行判斷測溫結果並自行治療屬於非常危險的行為, 請遵照醫師指示。
自行診斷病因可能會造成病情惡化。

本產品為腋下與口中用的體溫計。請勿使用於測量其他部位(耳朵等)的溫度。
以免無法正確測量溫度。並且可能造成耳朵等部位受傷。

請保管在嬰幼兒無法取得的地方。並且請避免兒童單獨使用本裝置。
否則可能因測量方式不正確而受傷。

請勿在本裝置被水份等液體淋濕的狀態下進行測量。
以免無法正確測量溫度。

⚠ 注意

請勿自行拆解、修理、改造。
否則可能造成測得的溫度有誤差, 或引發故障。

請將電池與螺絲放置在嬰幼兒拿不到的地方。
否則可能造成嬰幼兒誤食。萬一發生誤食情況時, 請立即送醫。

萬一電池液滲入眼睛, 請立即以大量的清水沖洗眼睛。
否則可能造成失明等傷害。請務必接受醫師治療。

一旦電池液附著於皮膚或衣物上時, 請立即以大量清水沖洗乾淨。
否則可能造成傷害。

請勿將電池投入火中。
否則可能造成電池損毀。

更換電池時, 請注意勿弄錯 $\oplus\ominus$ 方向。
以免因漏液, 發熱, 破裂等造成主機受損。


勿於存在著強烈靜電或電磁波的場所使用。
否則可能造成測得的溫度有誤差, 或引發故障。

正確測量方式

若使用者未以正確方式測量體溫時, 將無法保證測量精準度。

於腋下測量時

●頂住腋下的中央部位

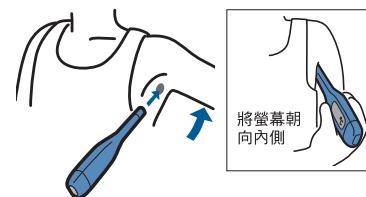

體溫的測量方式(測溫)

1 開啟體溫計電源。



顯示部位所有
圖示亮燈

88.8 °C



顯示前次測得的體溫
(顯示前次數值)


36.8 °C

代表為前次數值的符號

準備測溫中

37.0 °C

●稍微由下方往上抬後將其夾住 (夾緊腋下)

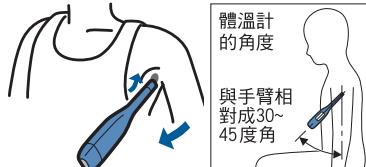

※使用於嬰幼兒等兒童身上時, 請輕輕壓住其
手臂, 以避免其腋下翹起。

於口中測量時

●頂住舌頭下方舌根的左方或右方



●以舌頭頂住體溫計 後閉緊嘴巴



●以手支撑體溫計來避免移位



2 當「°C」圖示開始閃爍時, 請將感溫部位頂住腋下中央, 並夾緊腋下。

※若要於口中測量
時, 請頂住舌下
的舌根部位



當「°C」開始閃爍時,
代表已完成測溫準備
動作

裝置將自動開始測溫, 此時
「°C」圖示將不斷閃爍



【注意】若外部氣溫(周圍環境溫度)超過32°C時, 可能會導致感溫部位一開始就過熱, 並使得體溫計在尚未測量前就顯示溫度。此時請先以充分擰乾的濕毛巾等物品冷卻感溫部位後再行測量。

3 當測得的溫度到達安定狀態時, 裝置會連續三次發出「嗶嗶嗶嗶」的提示音。

請確認測溫結果。

當測得的溫度值非常
安定時, 「°C」圖示
會轉為持續亮燈



■正確測量溫度的時間長度基準

腋下: 約10分鐘 口中: 約5分鐘

4 請關閉電源, 並將體溫計收入收納盒中。

●使用須知

雖然本裝置會在約30分鐘後(閒置狀態下則為約
分鐘後)自動關閉電源, 但為了維護電池壽命,
請勿使用時隨時關閉電源。

疑難排解

■每次測得的溫度值皆不同。

確認此處	處置方式
是否每次測量時, 體溫計感溫 部位頂住的位置皆不同?	請確認「正確測量方式」中 的「正確置入體溫計的方式」 頁面。

■即使按下電源鍵, 螢幕也不會顯示任何畫面。

確認此處	處置方式
電池的 $\oplus\ominus$ 方向是否錯誤?	請以正確方式裝入電池。
電池的電量是否已耗盡?	顯示部位是否出現「」圖示? 請更換新電池(LR41)。

■在準備測溫的過程中不會出現「37.0 °C」圖示。
若顯示「36.9 °C」~「37.1 °C」時, 可直接使用。但若即使重新
開啟電源後仍不斷顯示超出「36.9 °C」~「37.1 °C」範圍的圖示
時, 請洽詢歐姆龍客服中心。

顯示測得的溫度值以外的圖示

顯示內容	顯示錯誤訊息的原因	處置方式
L	感溫部位的溫度未滿32°C 時顯示。	此狀態並非故障, 請直接測量 體溫。
H	感溫部位的溫度超過 42°C時顯示。	可能是週遭環境溫度超過42°C 所致。請先冷卻感溫部位後再 行測量。

確保本產品使用壽命的注意事項

請遵守下列注意事項, 否則可能引發故障。

- 請勿使用於測量人類體溫以外的用途。
- 裝置本身或收納盒請避免受到強烈衝擊, 或有掉落、踩踏、震動等情況。
- 收入收納盒前, 請務必擦乾水分。擦拭時請務必使用乾布。

使用後注意事項

使用後的體溫計請加以保養, 並隨時保持在乾淨狀態。

- 請勿用力沖水, 或長時間泡在水中。
- 清除裝置本身的髒污時, 請使用乾布或柔軟的棉布擦拭。
- 若髒污情況非常嚴重時, 請先以沾溼清潔水或中性清潔劑的布巾擦拭, 或輕輕沖水後, 再以柔軟的乾布擦乾。
- 若使用酒精清除髒污時, 請避免接觸到螢幕部位。
- 請遵守下列事項, 以免導致產品故障。
 - 清除污垢時, 禁止使用揮發油與稀釋劑等。
 - 使用時請多加注意, 避免水份等液體進入裝置內部。
 - 請勿以浸泡至酒精內或以熱水(超過50°C的熱水)擦拭的方式消毒體溫計的感溫部位。
 - 請勿以超音波洗淨方式進行清潔。

使用後請務必將體溫計收藏於配件中的收納盒內妥善保管。

- 請勿存放在以下場所, 以免導致產品故障。
 - 可能被水淋濕的場所。
 - 高溫多濕, 陽光直射, 暖器設備附近, 灰塵較多, 空氣中含有鹽分等物質的場所。
 - 可能會有傾斜、搖動, 或遭受撞擊的場所。
 - 保存化學藥品, 或可能產生腐蝕性氣體的場所。